stryker

ICONIX

Alles-Faden Ankerplattform

Produktmerkmale & Vorteile

IntelliBraid Technology

Die IntelliBraid Technologie bewirkt einen Bündelungseffekt, indem spezielle Kompressionszonen innerhalb der Implantatumhüllung für eine stabile Fixation genutzt werden.

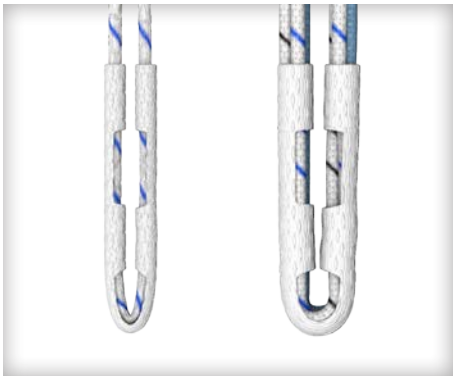

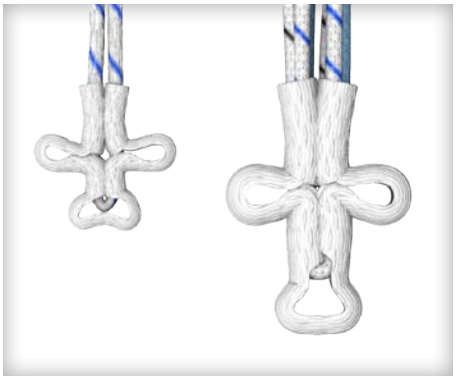

Knochenresektion

Die ICONIX Einwegbohrer sind mit einer einzigartigen selbstzentrierenden Technologie (SZT) ausgestattet, die eine exakte Platzierung der Vorbohrung gewährleistet. Mehrere Anker können auf einer kleineren Fläche platziert werden.

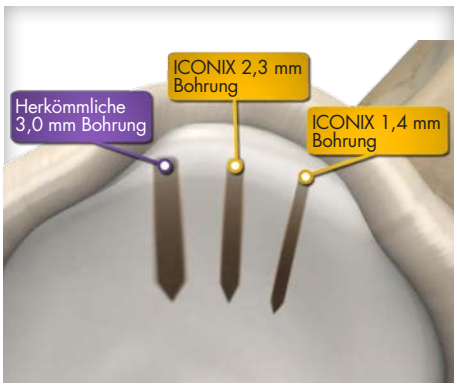

Instrumente

Bohrführungsoptionen 2,3 mm und 1,4 mm

Gerade, kurz
Gerade
12°
12°, abgeschrägt (Hüfte)
25°
25°, abgeschrägt (Hüfte)
Einweg-Kits

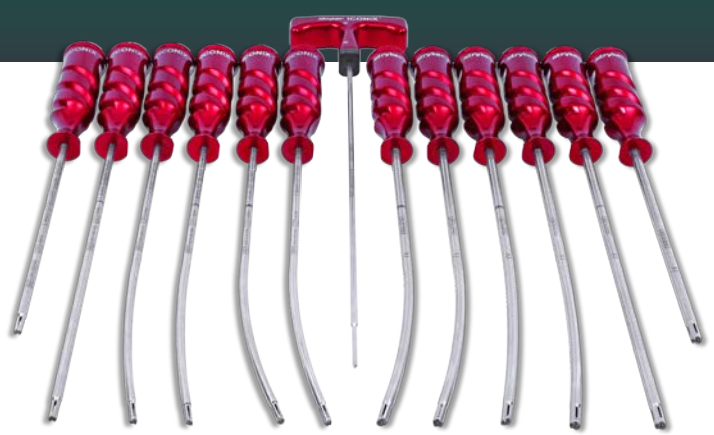

ICONIX Optionen
XBraid TT und Force Fiber

2,3 mm Selbststanzende Anker

ICONIX SPEED
mit 3x 1,2 mm XBRAID TT Nahtband

ICONIX SPEED
mit 2x 2,0 mm XBraid TT Nahtband

ICONIX SPEED
mit 2x Force Fiber Fäden Nr. 2

ICONIX SPEED
mit 1x 1,2 mm und 1x 2,0 mm XBraid TT Nahtband

2,3 mm Alles-Faden-Anker

ICONIX 2 mit Nadeln und 2x 2,0 mm
XBraid TT Nahtband

ICONIX 2 mit Nadeln und 2x Force Fiber Fäden Nr. 2

ICONIX 2 TT mit 2x 2,0 mm XBraid TT Nahtband

ICONIX 2 mit 2x Force Fiber Fäden Nr. 2

ICONIX 3 mit 3x Force Fiber Fäden Nr. 2

ICONIX 25 mit 2x Force Fiber Fäden Nr. 5

1,4 mm Alles-Faden-Anker

ICONIX 1 mit Nadeln und
1x 1,2 mm XBraid TT Nahtband

ICONIX 1 mit Nadeln und
1x Force Fiber Faden Nr. 2



ICONIX 1 TT mit 1x1,2 mm XBraid TT Nahtband

ICONIX 1 mit 1x Force Fiber Faden Nr. 2

Artikelnummer	ICONIX Implantate – Beschreibung test
ICONIX (mit Force Fiber Faden)	
3910-500-512	ICONIX 1 ALLES-FADEN-ANKER 1,4MM, 1x FORCE FIBER FADEN NR. 2, VE=5
3910-500-522	ICONIX 2 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM, 2x FORCE FIBER FÄDEN NR. 2, VE=5
3910-500-525	ICONIX 25 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM, 2x FORCE FIBER FÄDEN NR. 5, VE=5
3910-500-532	ICONIX 3 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM, 3x FORCE FIBER FÄDEN NR. 2, VE=5
ICONIX TT (mit Nahtband)	
3910-500-312	ICONIX TT1 ALLES-FADEN-ANKER 1,4MM MIT 1x XBRAID TT NAHTBAND 1,2MM, VE=5
3910-500-322	ICONIX TT2 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM MIT 2x XBRAID TT NAHTBAND 2,0MM, VE=5
ICONIX Nadeln	
3910-500-212	ICONIX 1 ALLES-FADEN-ANKER 1,4MM MIT NADELN UND 1x XBRAID TT NAHTBAND 1,2MM, VE=5
3910-500-412	ICONIX 1 ALLES-FADEN ANKER 1,4MM MIT NADELN, 1x FORCE FIBER, VE=5
3910-500-222	ICONIX 2 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM MIT NADELN UND 2x XBRAID TT NAHTBAND 2,0MM, VE=5
3910-500-422	ICONIX 2 ALLES-FADEN-ANKER 2,3MM 2x FORCE FIBER FÄDEN NR. 2, VE=5
ICONIX SPEED (selbststanzend)	
3910-500-921	ICONIX SPEED MIT 1x 1,2 MM UND 1x 2,0 MM XBRAID TT NAHTBAND, VE=5
3910-500-931	ICONIX SPEED MIT 3x 1,2 MM XBRAID TT NAHTBAND, VE=5
3910-500-920	ICONIX SPEED MIT 2x 2,0 MM XBRAID TT NAHTBAND, VE=5
3910-500-922	ICONIX SPEED MIT 2x FORCE FIBER FÄDEN NR. 2, VE=5

Endoscopy

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss die medizinische Fachkraft stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: ICONIX, XBraid und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Material ist nicht für den Vertrieb außerhalb der EU und der EFTA vorgesehen.

SDL 11/2019
2018-17911

Copyright © 2019 Stryker
stryker.com

Stryker GmbH & Co. KG
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1
47228 Duisburg
Deutschland

t: +49 2065 837-0
f: +49 2065 837-837

www.stryker.de